



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-12236-R1 PARA ADQUIRIR CAMAS DE POSICIONES ANTILIGATURAS Y MATTRESS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: RESPUESTAS A PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la subasta de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones:

Licitador: STRONGMED CORP.

1. Nos gustaría saber un número aproximado de camas y colchones solicitado, para poder cumplir con los tiempos de entrega.


Respuesta: La cantidad es indeterminada ya que con esta subasta se establecerá un contrato por dos (2) años para la adquisición de estos equipos. Se podría emitir una primera orden de compra de alrededor de veinte (20) camas y mattresses.

Licitador: QUICK DELIVERY SERVICES

2. En las especificaciones del pliego mencionan dos (2) cables de corriente distintos. El cable corto de tres (3) pies y el cable de desconexión rápida de ocho (8) pies. La cama viene con uno o el otro, no ambos. Nos gustaría saber cuál de los dos es el que requieren.

Respuesta: Ver Enmienda Núm. 1. (Favor hacer referencia a la imagen).

Short and quick – disconnect power cord options. To reduce the risk of patient self – harm, choose a quick-disconnect power cord or a short one that is securely fastened.

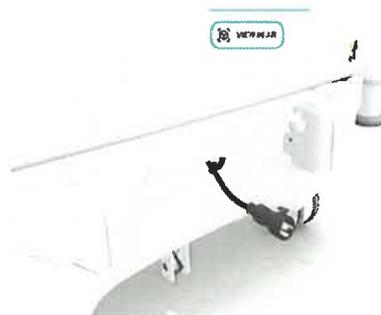

Licitador: UNIVERSAL CARE CORP.

3. Ítems a; ¿Estas dimensiones son de la parte externa o de la superficie del paciente?

Respuesta: Son de la superficie del paciente.

4. Ítems b; ¿Podemos ofertar un producto de 250 kgs que son 551 libras?

Respuesta: Se requiere un mínimo de 600 lbs.


5. Ítems c; ¿Qué es un tablero (Board) permanente?

Respuesta: *Board = head and foot boards are permanently attached to the frame to prevent patients from causing injuries. (No es removible). (Favor hacer referencia a la imagen).*



6. Ítems e; ¿A qué se refieren con un filled board, y siderails?

Respuesta: *Filled Board & Siderails = limits the risk of self – harm and the potential use as a ligature point. (Favor hacer referencia a la imagen).*

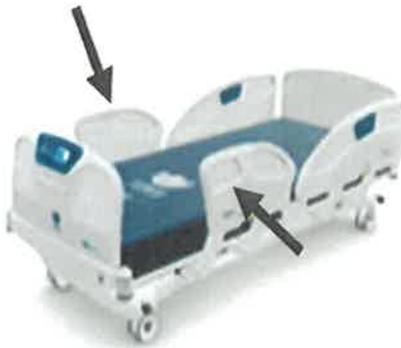

7. Ítems f/ Ítem p; ¿son prácticamente el mismo punto, pero a que se refieren con que sean removibles?

Respuesta: Los cables pueden estar ocultos, pero a la misma vez se puedan remover para mayor seguridad. (Favor hacer referencia a la imagen).

Concealed cable = cables and wires areas are concealed to minimize the risk of using them as a ligature.



8. Ítems l; ¿menciona un tablero de control de movimiento de la cama en el piecero?

Respuesta: (Favor hacer referencia a la imagen).



9. Ítems r; ¿A qué se refieren con accessory socket caps?

Respuesta: (Favor hacer referencia a la imagen).



Para el colchón

10. Ítems a; ¿A qué se refieren con diseño reversible de 1 capa / 1 zona (de cabeza a pies)?

Respuesta: Revestible se refiere al material del cual esté hecho. El revestimiento debe ser en *vinil hospital grade* en una sola pieza con costura oculta reforzadas. Mattress deben ser impermeables, sin zipper y costura *heavy duty*.


11. Ítems d; ¿A qué se refieren con concha de almeja y donde deben estar las asas reforzadas?

Respuesta: Es la unión del material. Las esquinas y costuras deben ser de tal manera que estén reforzadas. Las asas reforzadas están en los lados del mattress.

12. Ítems g; No podemos cumplir con este requerimiento, presentamos una alternativa con cremallera y solapa que cubre la cremallera.

Respuesta: No se acepta. No pueden tener zipper.

Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

Emitido hoy, 19 de abril de 2023
San Juan, Puerto Rico

